


СХЕМА 1.1 СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ МАНОМЕТРОВ, МАНОВАКУУММЕТРОВ, ВАКУУММЕТРОВ

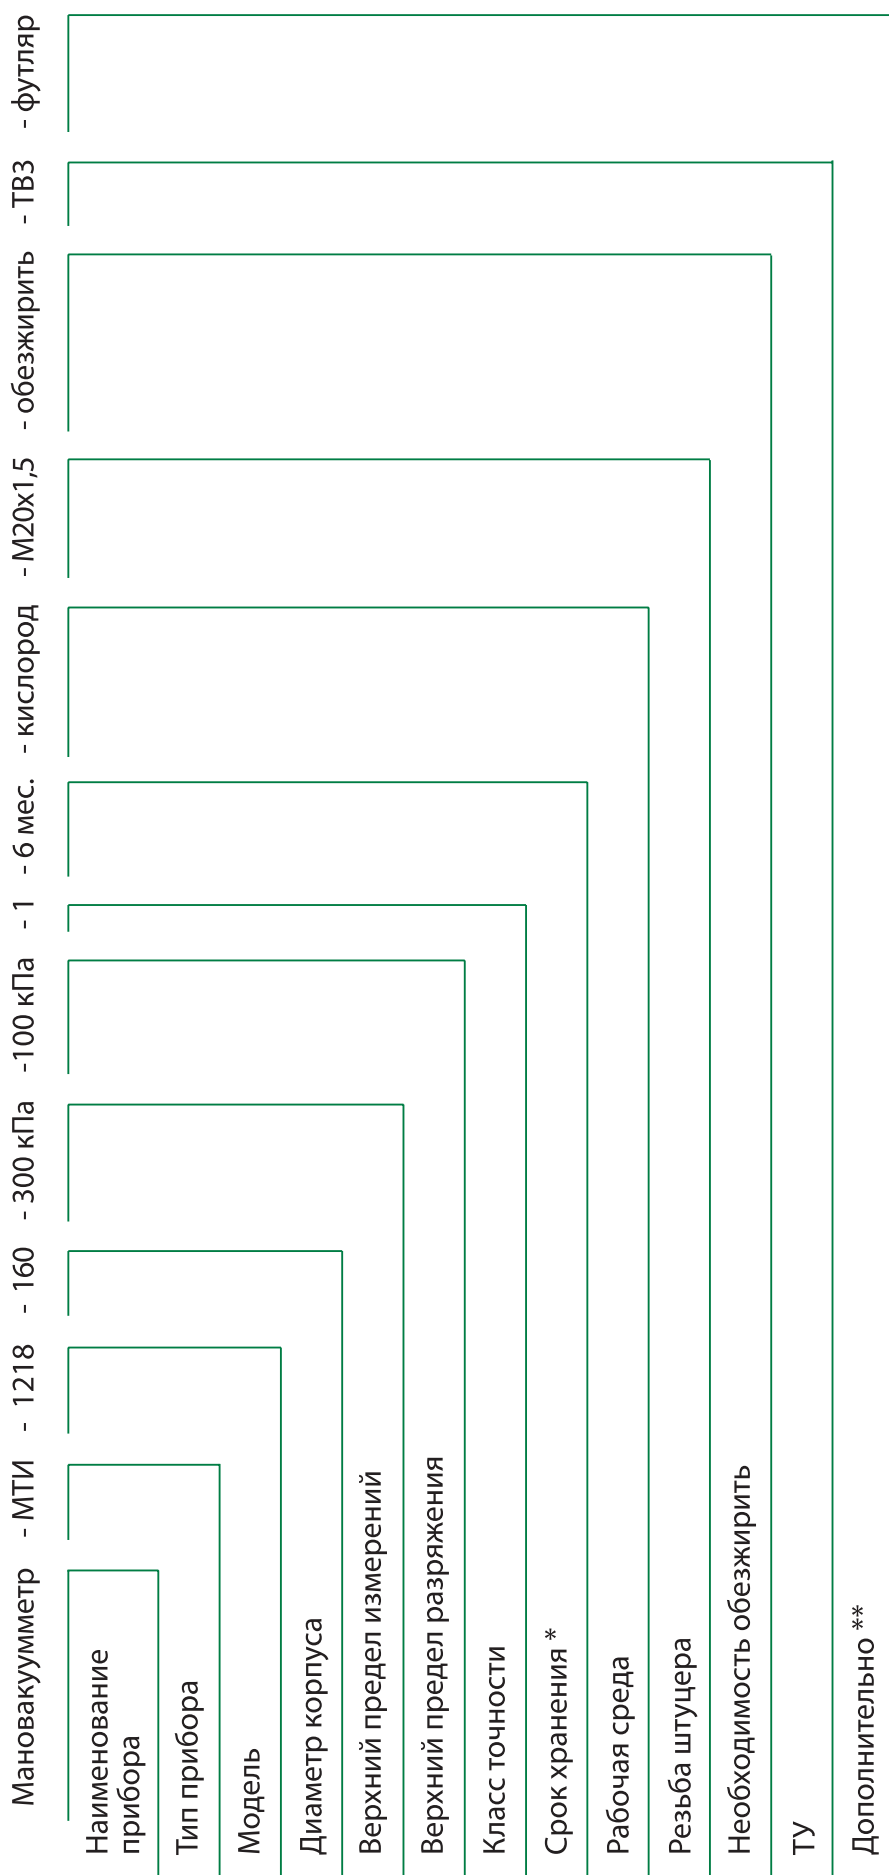

* - если срок хранения более одного года

** - при необходимости стойки и/или футляра

При отсутствии каких либо требований параметр не заполняется